

SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 19 tháng 7 năm 2023

Số: 969 /TM-KSBT

V/v Thư mời chào giá xây dựng Kế
hoạch Mua máy phun thuốc chống
dịch (đeo lưng) ULV

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị.

Căn cứ Công văn số 1256/UBND-KGVX ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh kính mời Quý đơn vị có nhu cầu, khả năng cung cấp máy phun thuốc chống dịch (đeo lưng) ULV, gửi báo giá về Trung tâm để có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm phục vụ hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 như sau:

1. Danh mục báo giá (Phụ lục kèm theo)

2. Các tài liệu liên quan khác nếu có.

- Giá chào của hàng hóa là giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí.

- Báo giá có giá trị 90 ngày trở lên.

- Thời gian gửi báo giá: **Đến trước 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2023.**


- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản scan đã đóng dấu và gửi qua Email: pkhny.ksbtiv@gmail.com

- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh số 79 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Khoa TT GDSK đăng Web SYT, CDC;
- Lưu: VT, KHN.V.

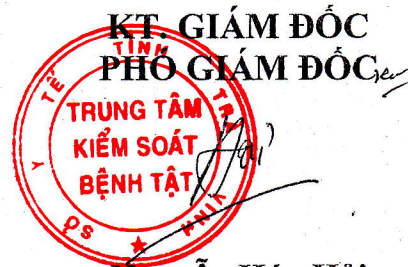

Nguyễn Hóa Hải



Phụ lục

THÔNG TIN CHI TIẾT HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Khai Bảo Thu mời số 969 /TM-KSBT ngày 19 tháng 7 năm 2023)

TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền	Giá kê khai	Mã kê khai
1	Máy phun thuốc chống dịch (đeo lung) ULV	<ul style="list-style-type: none">- Sản xuất năm 2022- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001- Động cơ hai thì một xi lanh: 63.3cc- Công suất động cơ: 2,9kW/ 3,9hp- Tốc độ động cơ không tải: 3.000rpm- Hệ thống đánh lửa điện tử- Khoảng cách đánh lửa: 0.5mm- Trọng lượng: 12,2kg- Bình nhiên liệu: 1.7 lít- Dòng thổi tối đa: 1.300m³/ giờ- Vận tốc gió: 90m/ giây- Dung dịch bình chứa thuốc: 14 lít- Dòng thổi tại miệng vòi: 920m³/ giờ- Tốc độ phun: 0.05-2.64 lít/ phút- Dãi phun: dọc 13m – ngang 14.5m- Độ ồn áp lực theo ISO 11201: 97dB- Độ ồn năng lượng theo ISO 3744: 108dB- Độ rung theo ISO 8662: 1.9m/s²- Thiết bị chuẩn: chế hòa khí bơm màng – đánh lửa điện tử - hệ thống lọc khí sử dụng lâu – hệ thống chống rung – tay nắm gạt máy- đai đeo – bộ đầu phun sương (ULV) 0,5mm, 0,65mm, 0,8mm	Cái	11				